Ansicht ohne 8305930
(Frontteil)

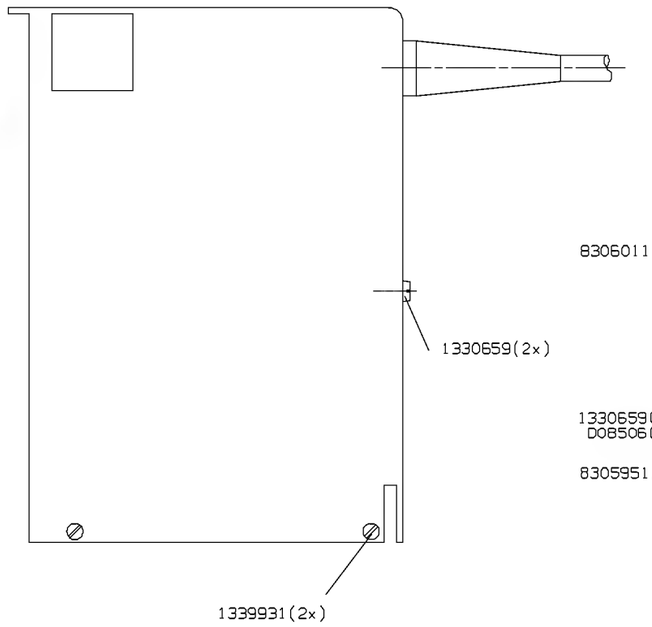

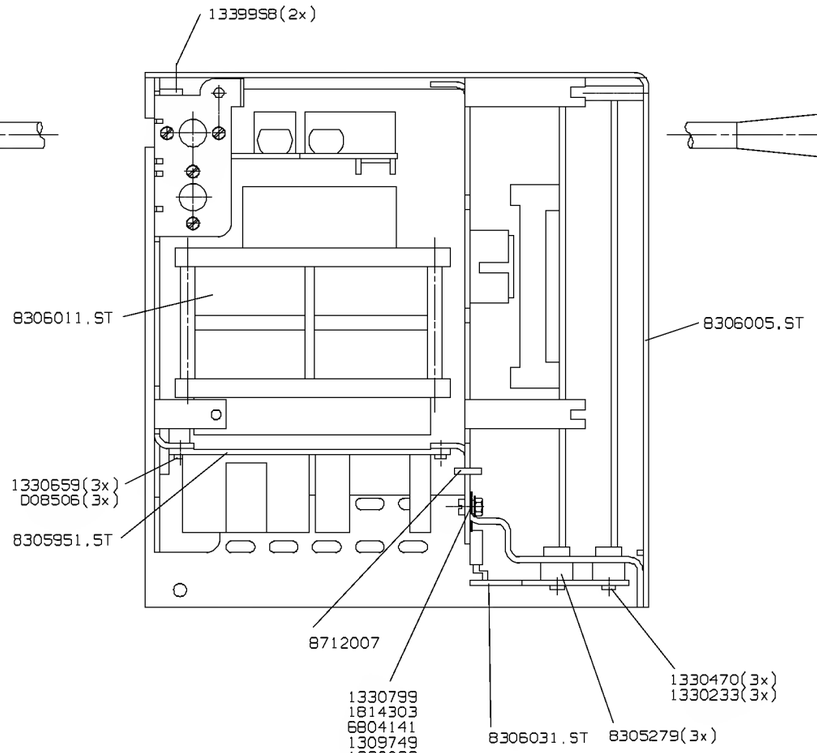

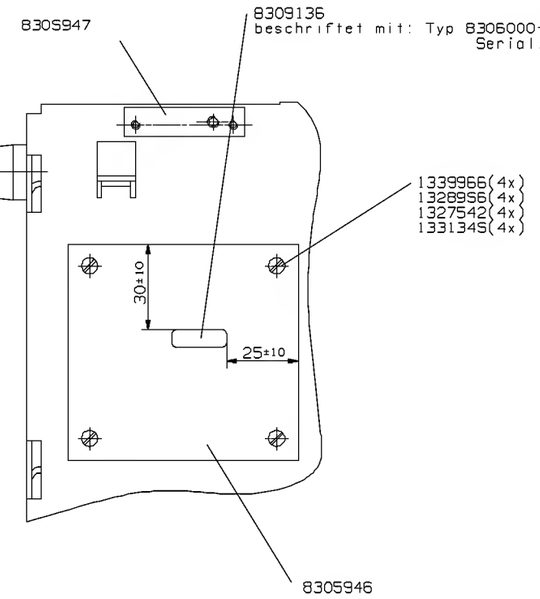

Z 2:1

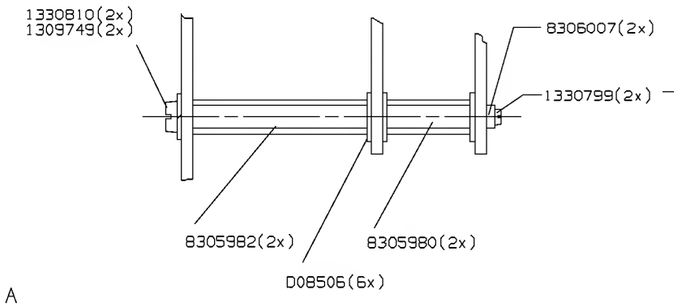

A

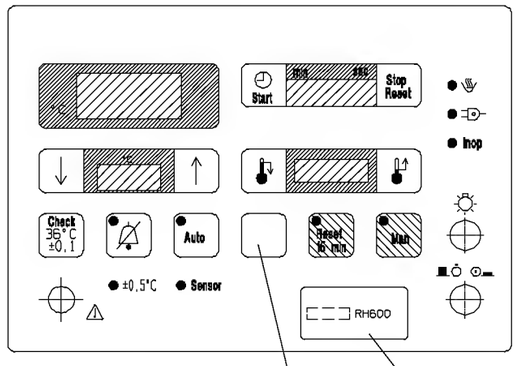

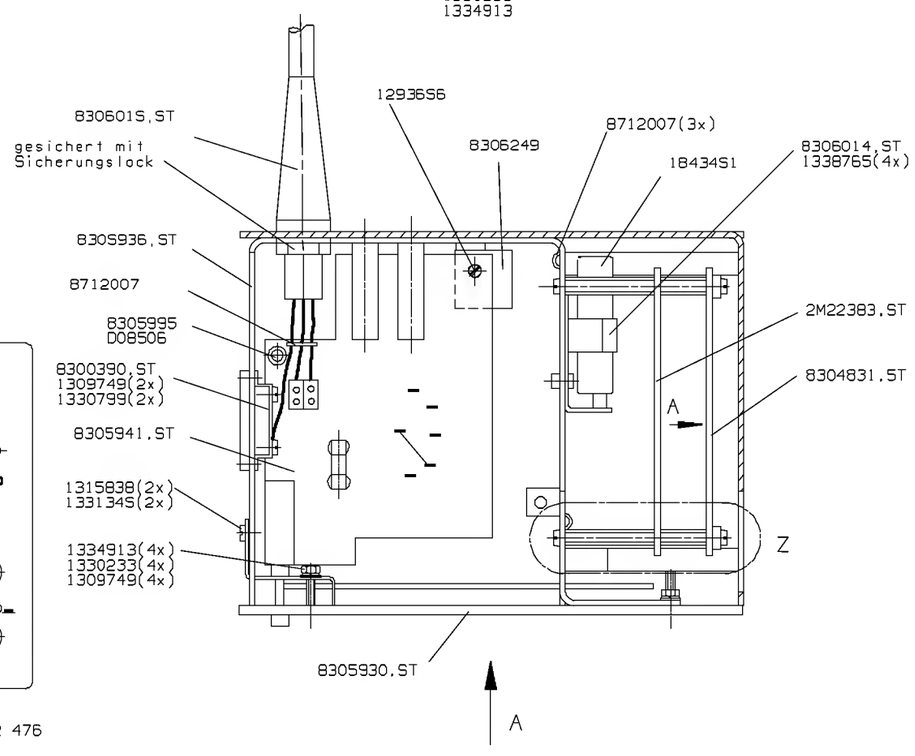

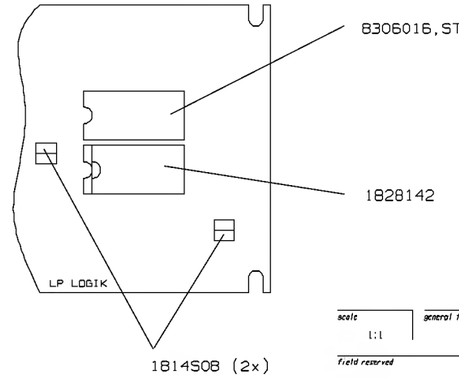

* ausgefuellt vom Lieferanten

Hierzu:

FKV		K02627
Registrierprotokoll		2M22428*
Verbindungsschemo		8305928
Kabelschemo		8306019
Stueckliste	ST	8306000
Blockschaltbild		8306133
Kabelbinder		8712007(10x)

Hersteller: Fa. Pro-Tech
Traceable: DMTN 0418-E1X

0x LP Logik 2M 22 408
0x LP Logik 2M 22 409

scale 1:1	general tolerances	material		safety class	0 / 0
field reserved		revision text: Rev.-Index berichtigt			(2001/DC/16)
filing dept. 2950	responsible dept. 5511		author	approved	controcl
		date	13 03 2001	13 03 2001	
		name	Stickel	Hartwig	
type: drawing	language: de	title: Elektronik Strahlungshzg.			
	replacement for: 8306000-12	number: 8306000			
creating system: CADRA	release status: RELEASED	revision index: 13	pieces: 1x	page/of: 01/01	

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A1

1. Auf gewuenschte Netzspannung am Transformator umklemmen.

2. Loetbruecken nach Plan umloeten.

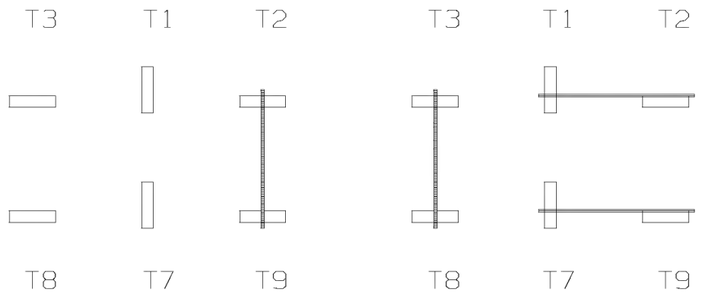

200 V/240 V 100 V/127 V

3. Umstellung der Kodierschalter nach der Tabelle.

4. Sicherungen gemaesz der Tabelle.

5. Beschriftung des Leistungsschildes mit den mit ✳ gekennzeichneten Daten der Tabelle.
Bei der Spannungsumstellung ist die Fabr.-Nr. vom 230 V Geraet zu uebernehmen.

Datentabelle

✳ Netzspannung	100 V ~	110 V ~	120 V ~	127 V ~	230 V ~	240 V ~
✳ Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
✳ Leistung	530 W	640 W	735 W	860 W	700 W	770 W
✳ Hauptsicherung	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250
SI 1	1,25 A T	1,25 A T	1,25 A T	1,25 A T	0,63 A T	0,63 A T
SI 2	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T
SI 3 + SI 4	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T
Schalterstellung	1 ▪▪▫▪▫▫▫▫ 8	1 ▪▪▪▪▫▪▪▫ 8	1 ▪▪▪▪▪▫▫▫ 8	1 ▪▪▫▫▫▪▪▫ 8	1 ▪▫▫▫▫▫▫▪ 8	1 ▪▪▪▪▪▪▪▫ 8

(11)

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author. All rights reserved.
DRAEGERWERK AG, Luebeck

=QA= --	=QB= --	=QC= --				
Werkstoff: SM-Papier DIN A3 ws hf 80g/qm			11	1x	Spalte fuer Leistung geaendert	
					(53/96)	
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab: ----	Allgemeintoleranzen: ----	Abteilung: M2	1996	Tag	Name	Draegerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Bearb	27.03.	Gonell/Sti.	
			Gepr.	27.03.	Aval	
PROD	CADRA=8	Benennung: Umruestanweisung (fuer 2M19300)				Zeichnungs-Nr.: 2M19349
						Ersatz fuer 2M19349-10
						Ersetzt durch